
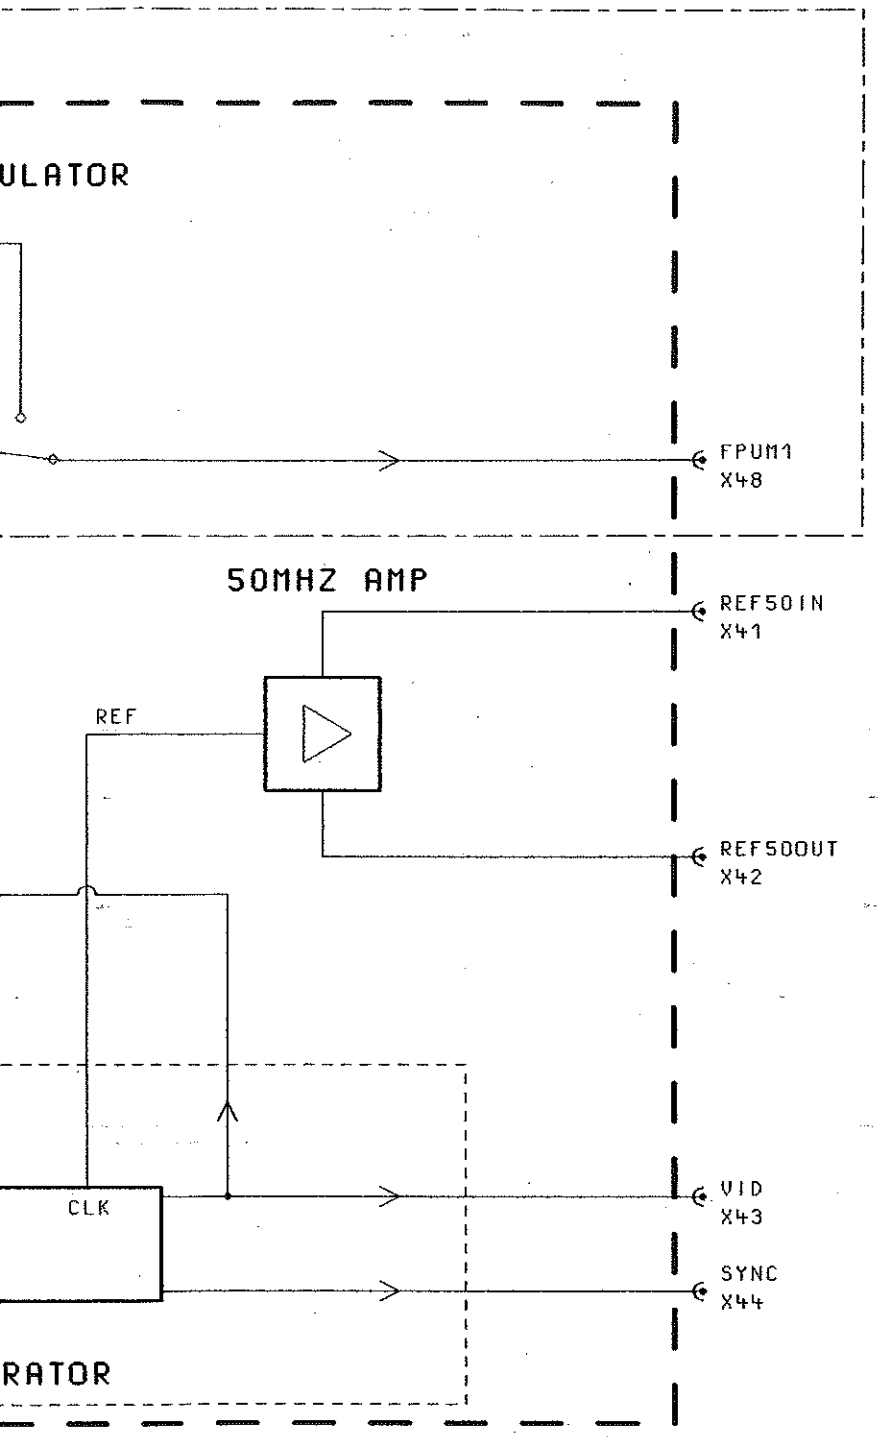


STROMLAUF GILT FUER VAR.02, 04, 06, 08, 10

CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02, 04, 06, 08, 10

02/	48738	01.03.93	JN	1GPK	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		JN	PULSMODULATOR
				GEPR.			PULSE-MODULATOR
				NORM			
				PLOTT	04.08.94		
/	48738	12.92	JN	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1036.6370.01S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SM-B3			BLATT-NR. 1+
				REG.I.V. 1036.6340			ERSTE Z. V. BL.

!
EHRDETE
N EINE
UNG.
D!
E DEVICES
NDLING

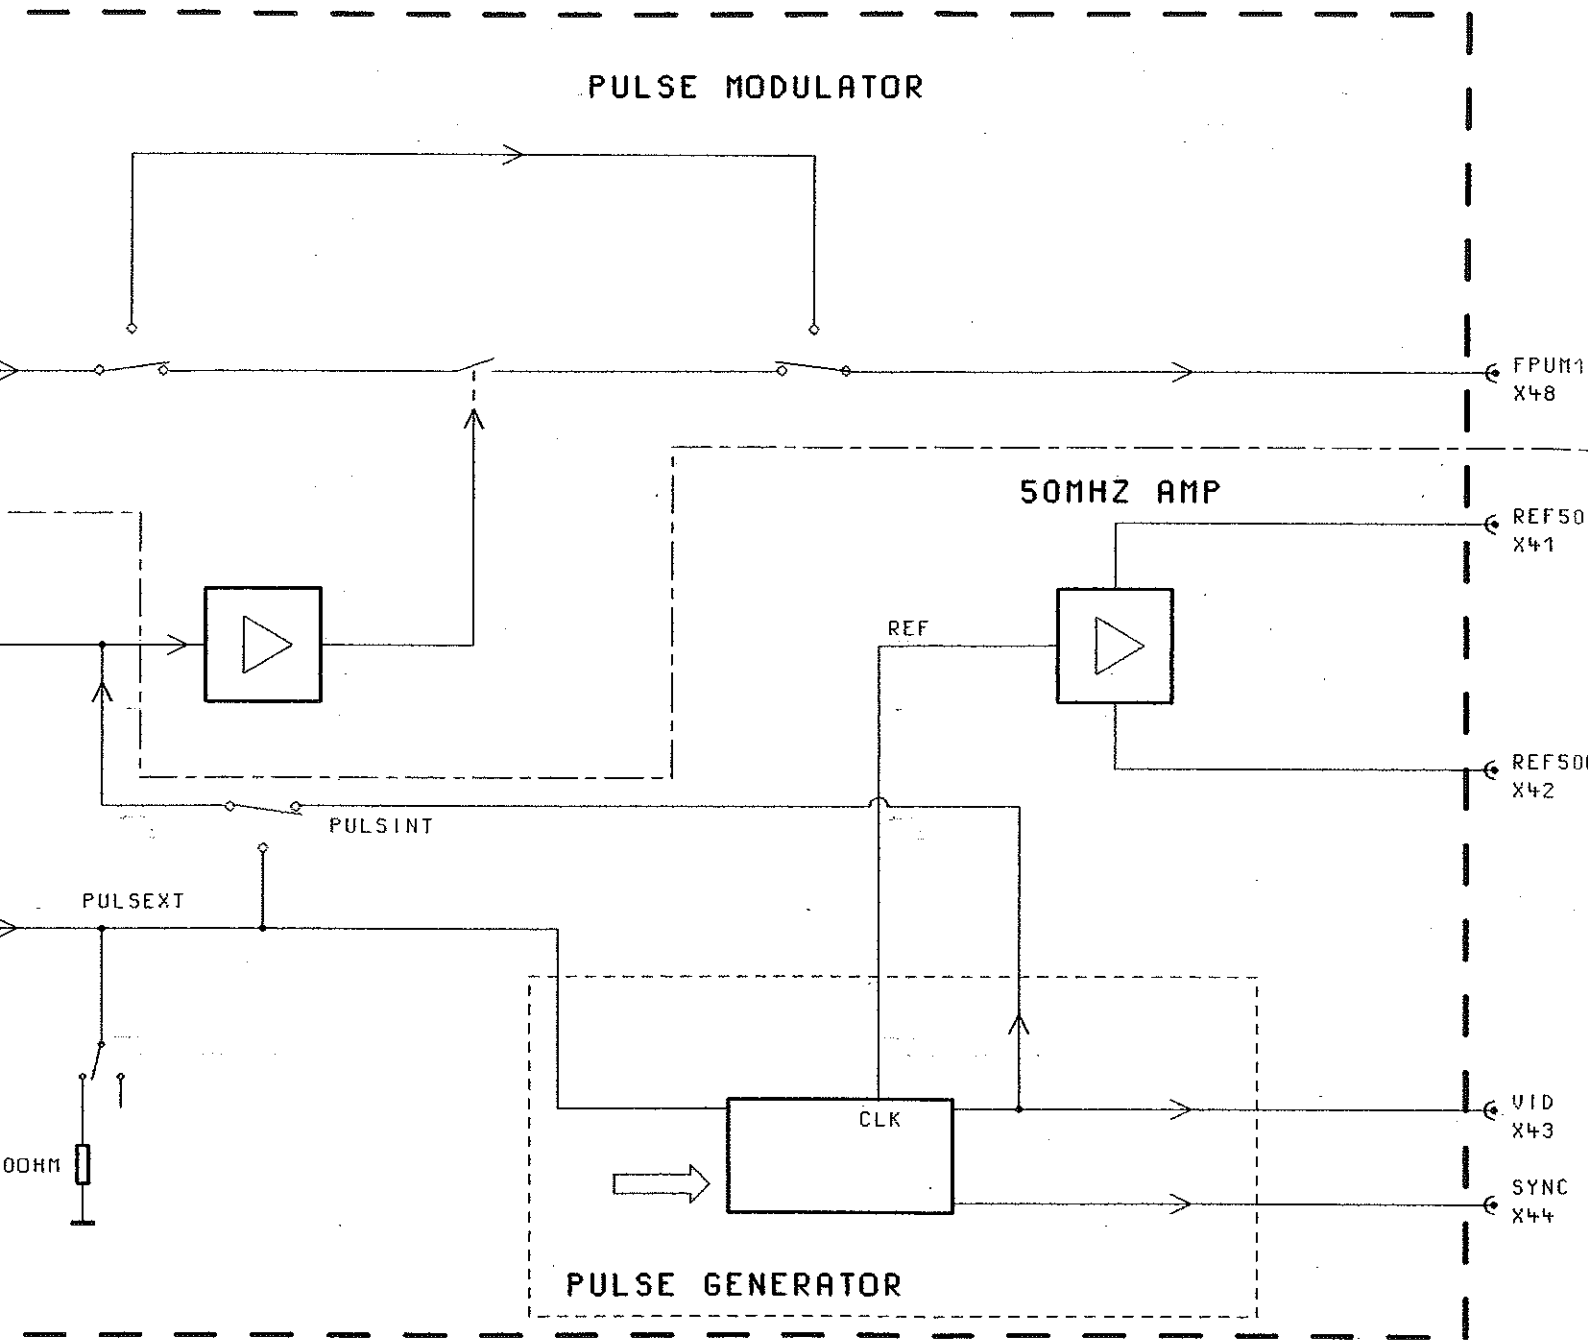


STROMLAUF GILT FU

CIRCUIT DIAGRAM IS VALID

02/	48738	01.03.93	JN	1GPK	TAG	NI
				BEARB.		
				GEPR.		
				NORM		
				PLOTT	04.08.94	
/	48738	12.92	JN			
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ROHDE&SCHU		
				ZU GERAET	SM-B3	

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

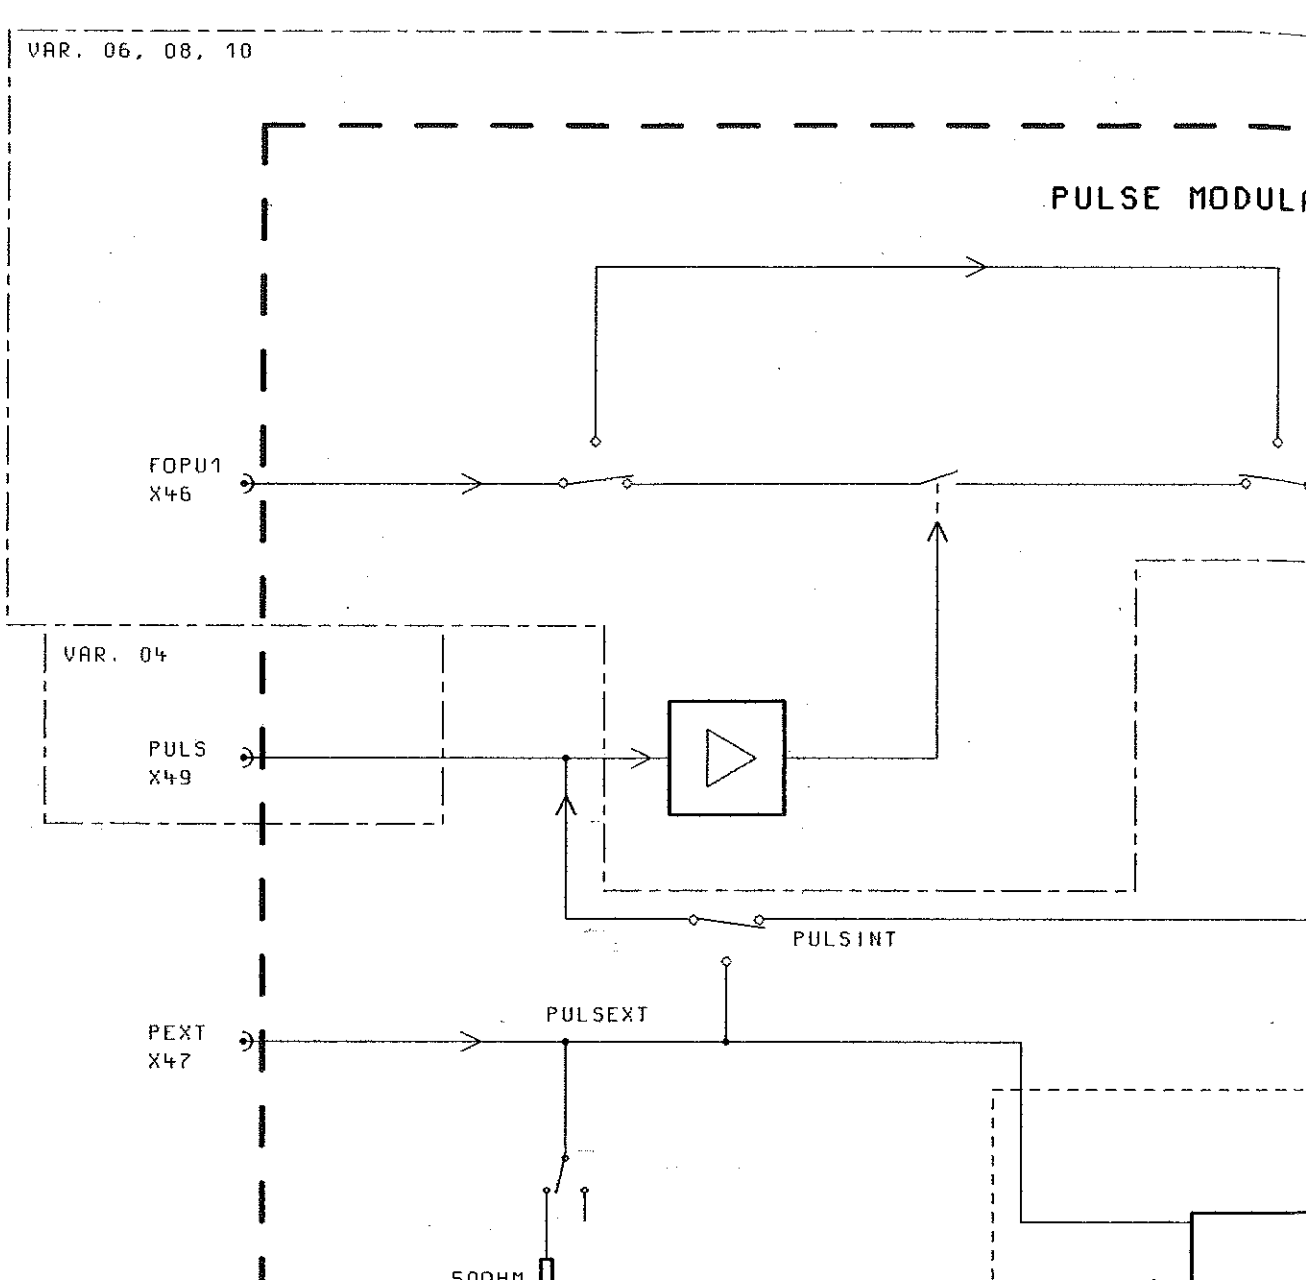


FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

ZEICHN.-NR.

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVI
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

CONTROL INTERFACE

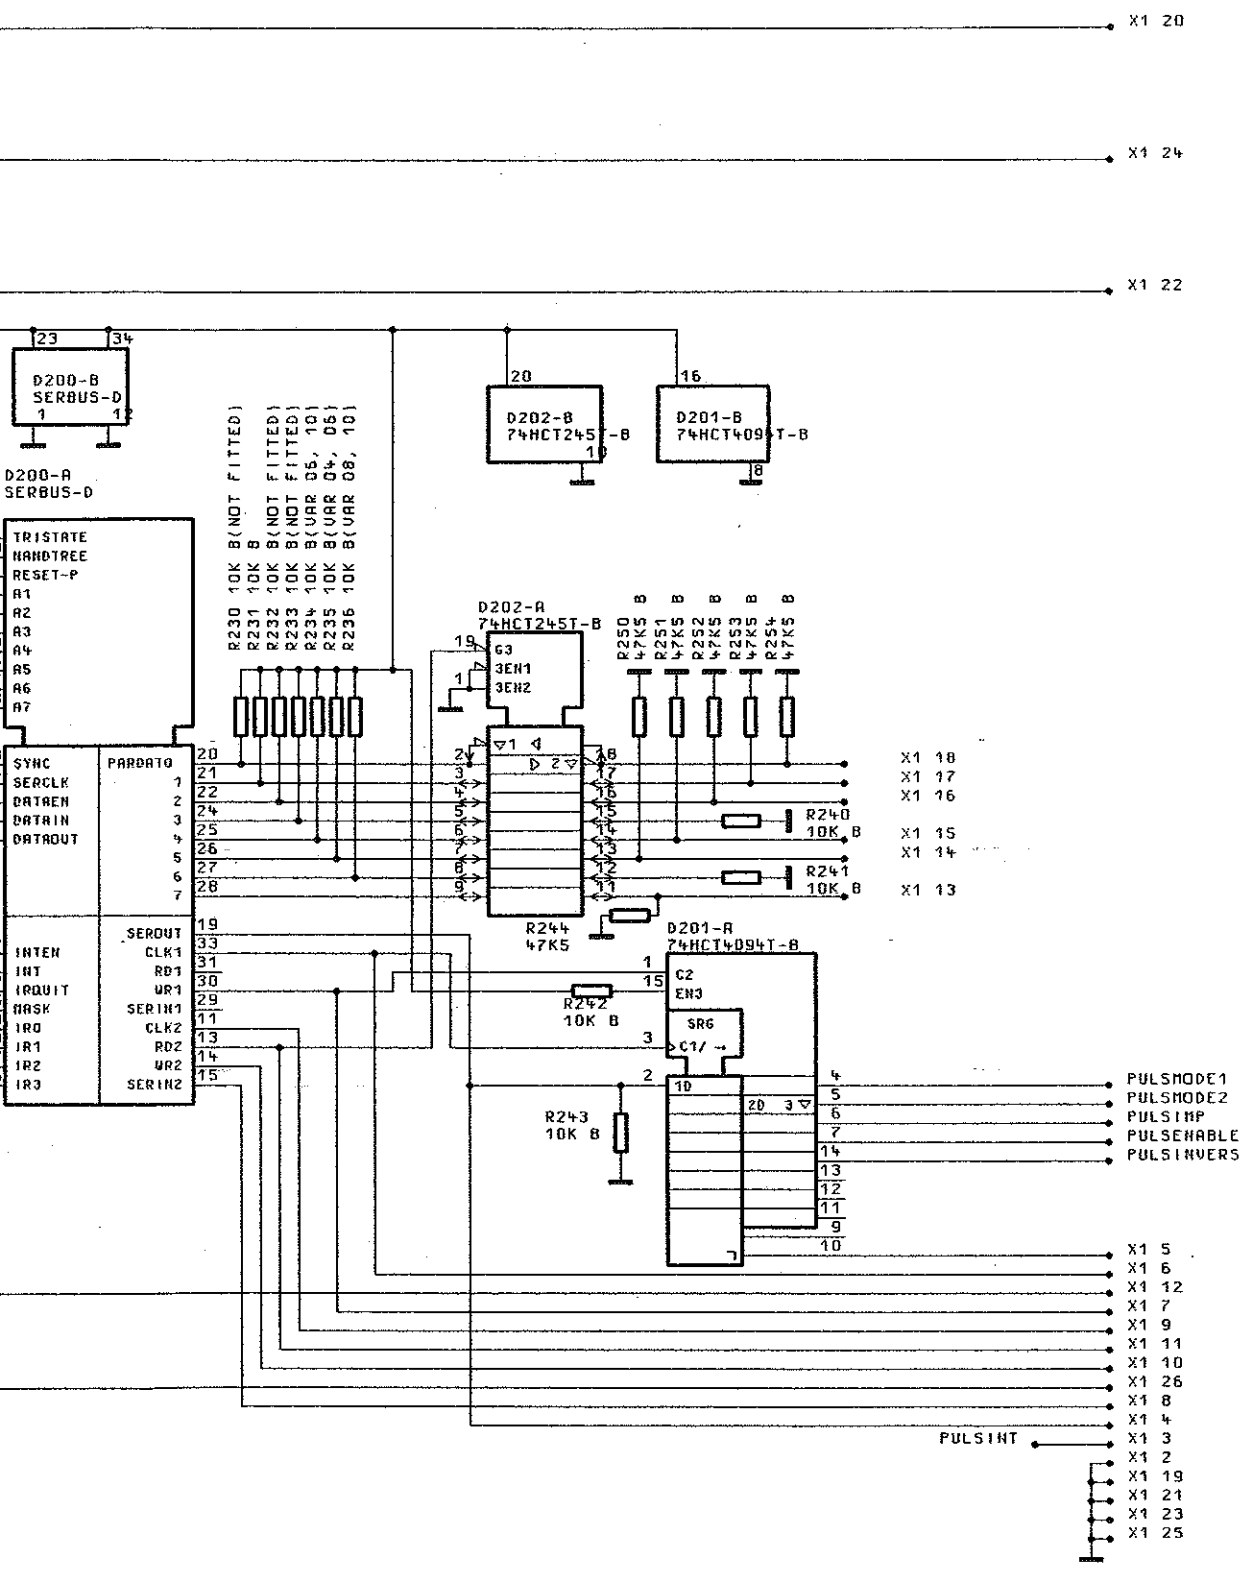


02/	48738	01.03.93	JN	1GPK	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		JN	PULSMODULATOR
				GEPR.			PULSE-MODULATOR
				NORM			
				PLOTT	04.08.94		
/	48738	12.92	JN	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1036.6370.01S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET	SM-B3		PEG.I.V. 1036.6340

BLATT-NR. 2+ | V. | BL. | ERSTE Z.

08, 10

B DIGITAL CONTROL INTERFACE

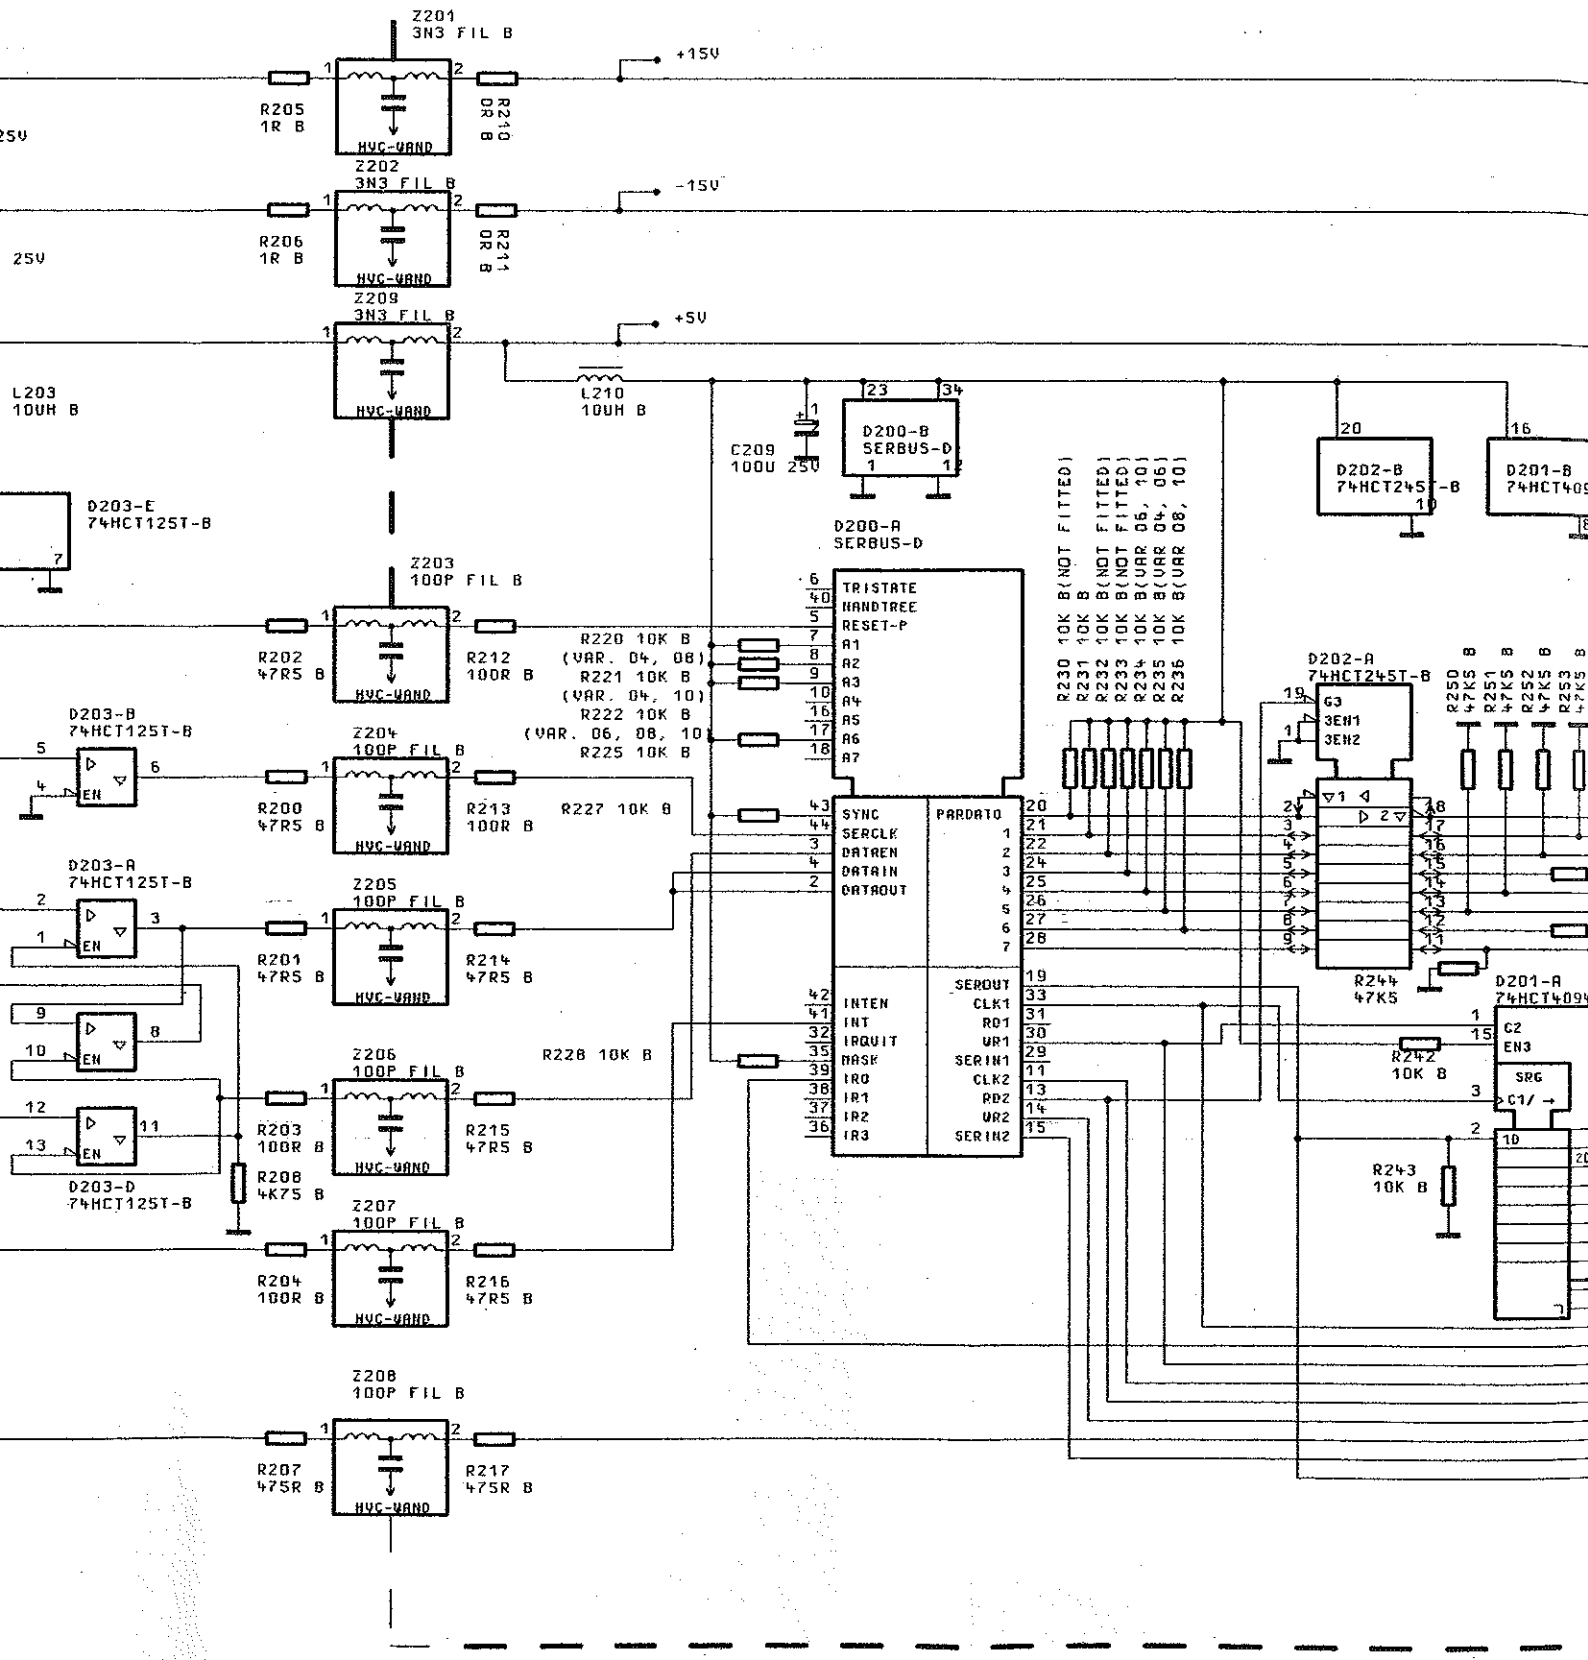


STROMLAUF GILT FUER VAR.02, 04, 06, 08, 10

CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02, 04, 06, 08, 10

02/	48738	01.03.93	JN	1GPK	TAG
				BEARB.	
				GEPR.	
				NORM	
				PLOTT	04.08.94
/	48738	12.92	JN		
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ROHDE&SC	
				ZU SERIE1	SM-B


FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

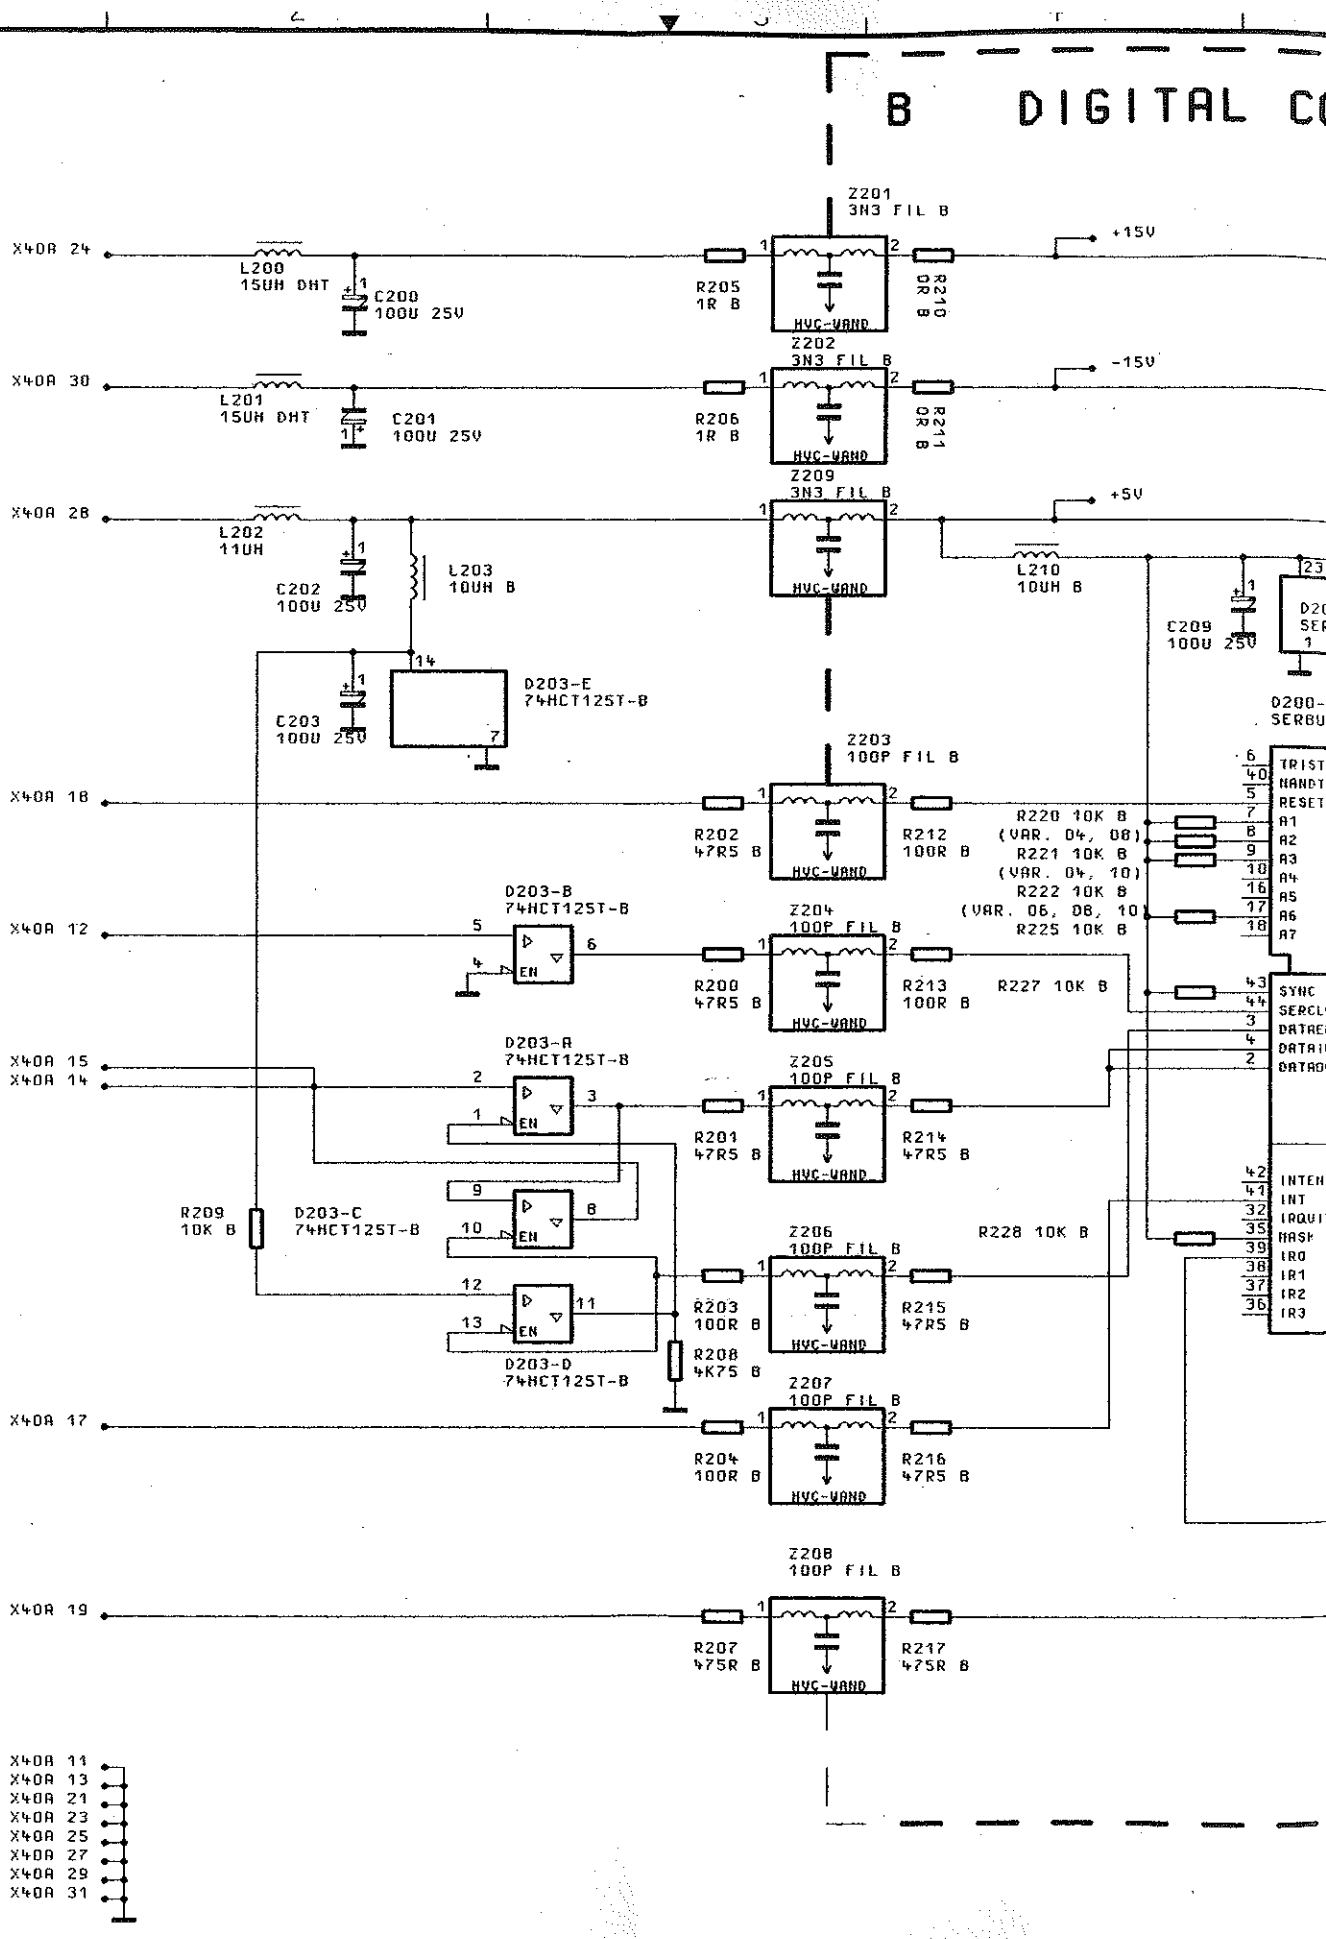

STROMLAUF GILT FUER VAR.02, 04, 06, 08,


CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02, 04, 06, 08, 10

ZEICHN.-NR

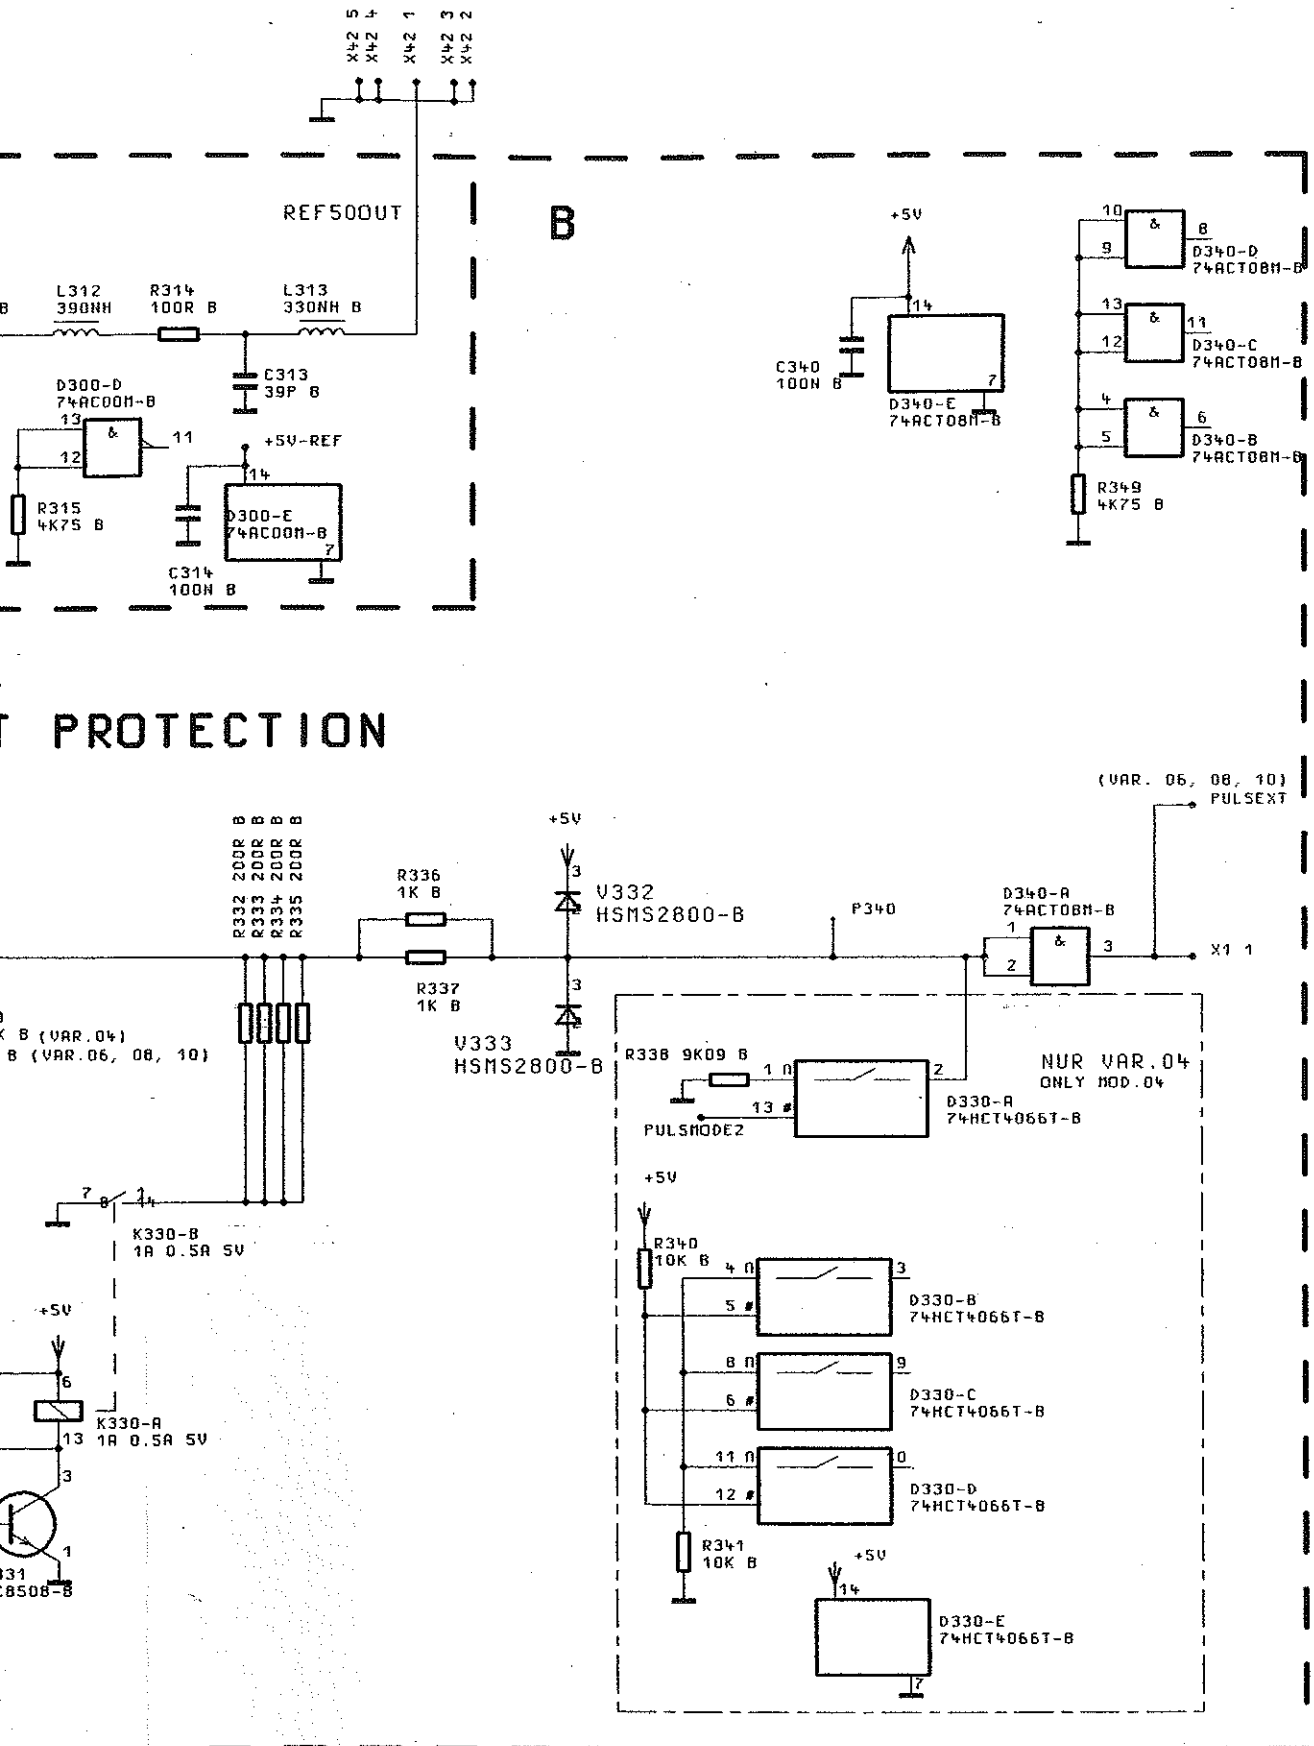


02/	48738	01.03.93	JN	16PK	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		JN	PULSMODULATOR
				GEPR.			PULSE-MODULATOR
				NORM			
				PLOTT	04.08.94		
/	48738	12.92	JN	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1036.6370.01S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SM-B3			REG.I.V. 1036.6340 ERSTE Z.

BLATT-NR. 3+ U. BL.

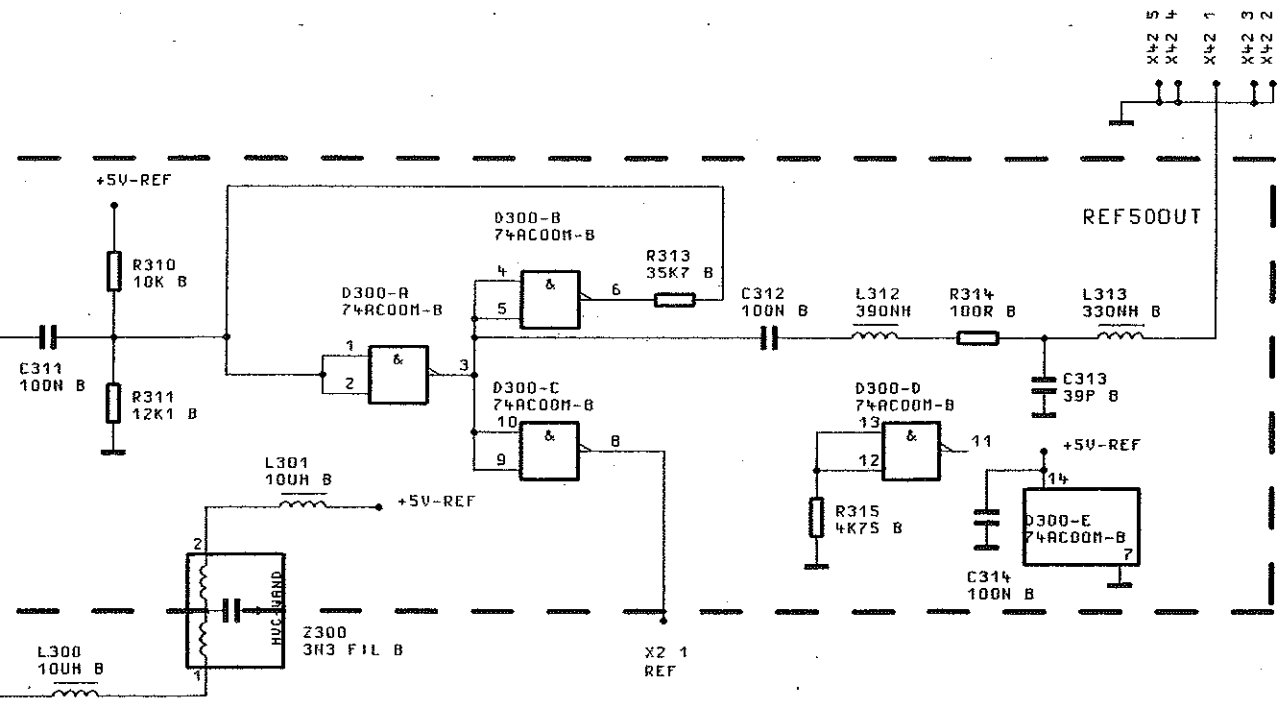


INPUT PROTECTION

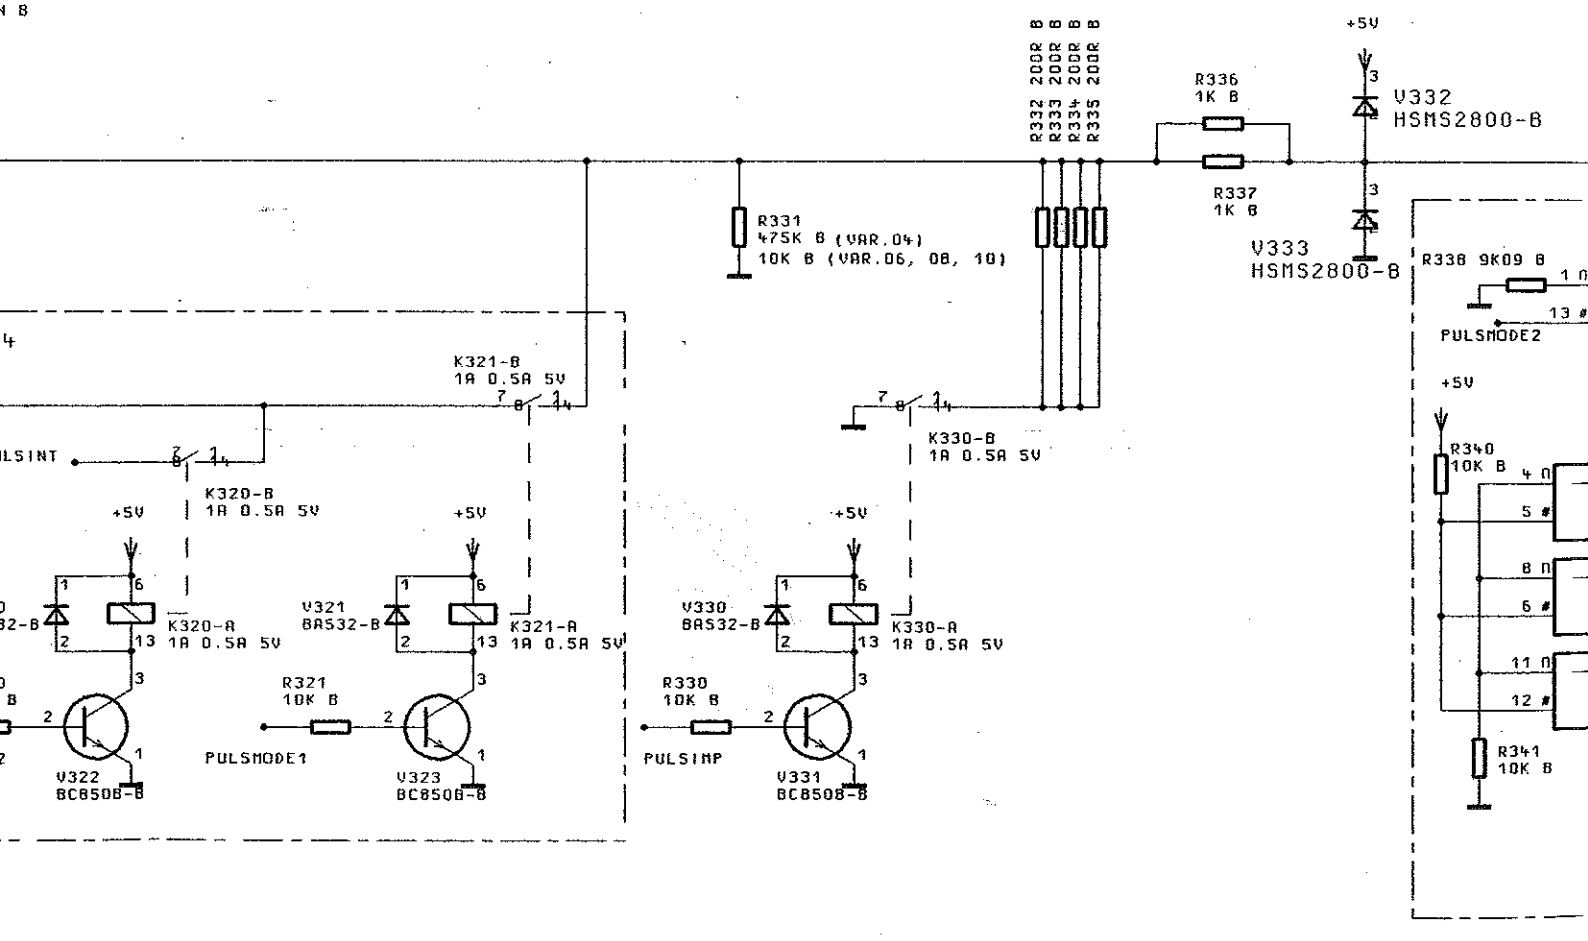

ROMLAUF GILT FUER VAR.02, 04, 06, 08, 10

UIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02, 04, 06, 08, 10

02/	48738	01.03.93	JN	16PK	TAG	NA
				BEARB.		J
				GEPR.		
				NORM		
				PLOTT	04.08.94	
/	48738	12.92	JN	ROHDE&SCHU		
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZB GERAET	SM-B3	

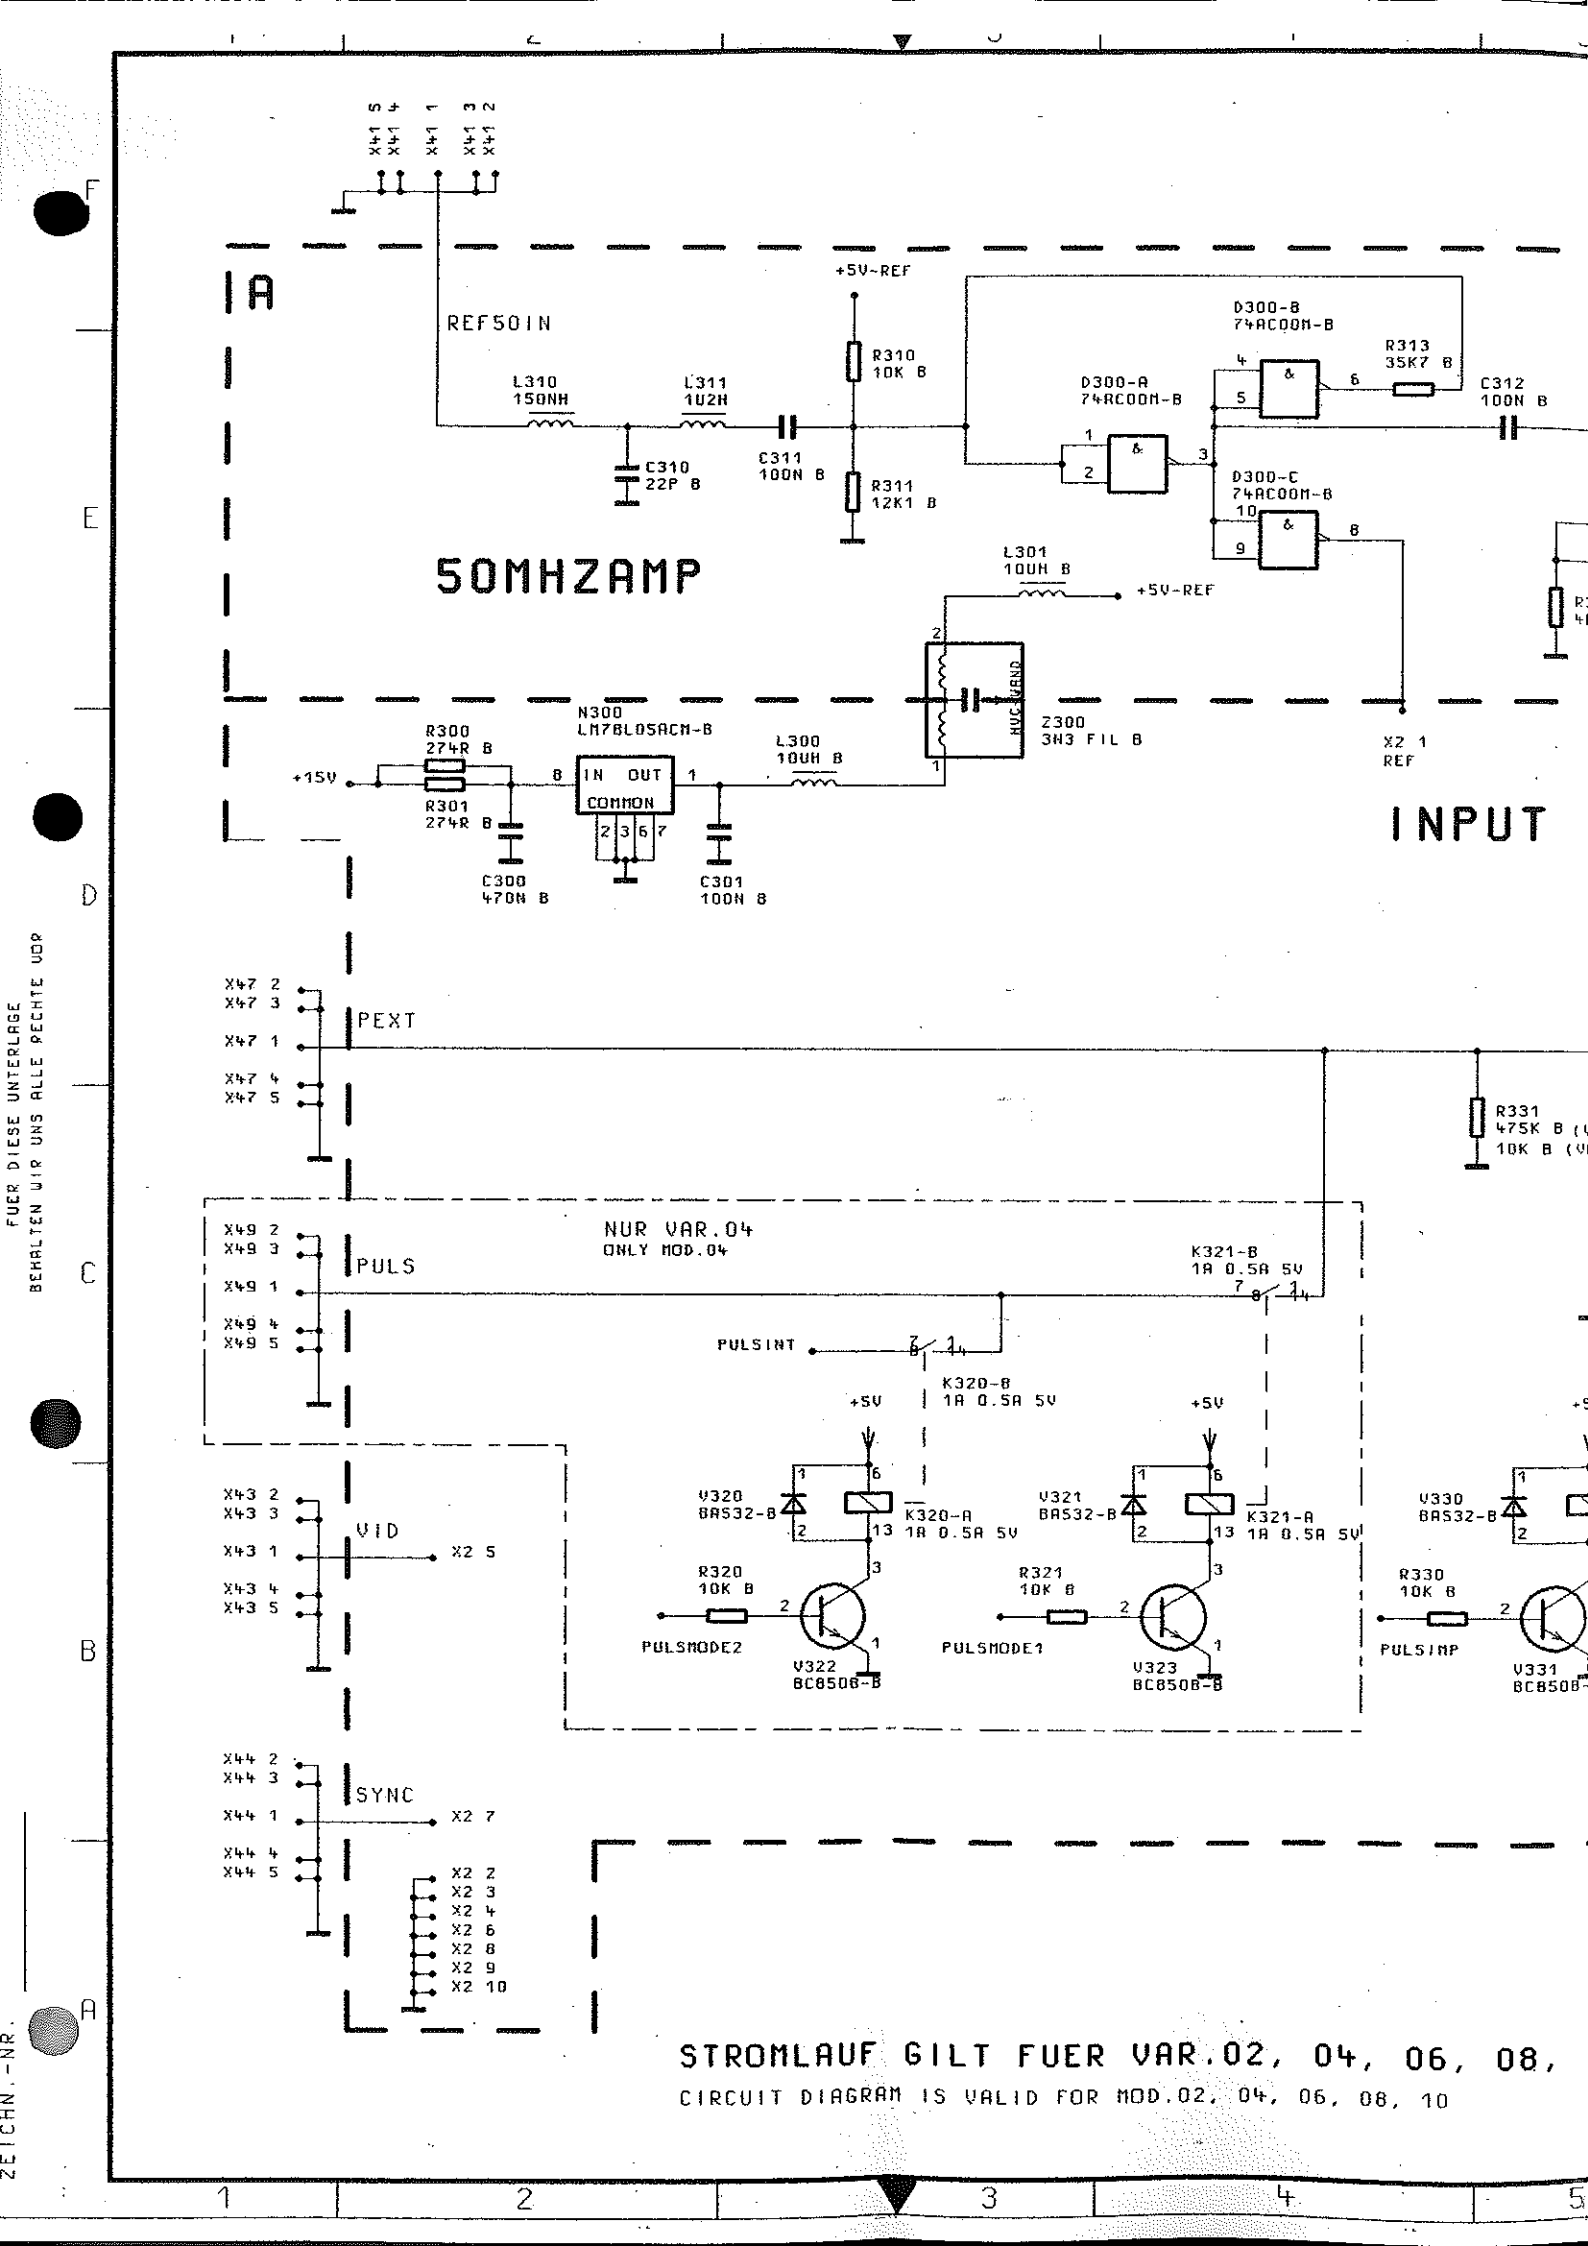


STROMLAUF GILT FUER VAR.02, 04, 06, 08,

CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02, 04, 06, 08, 10


FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

ZEICHN.-NR.

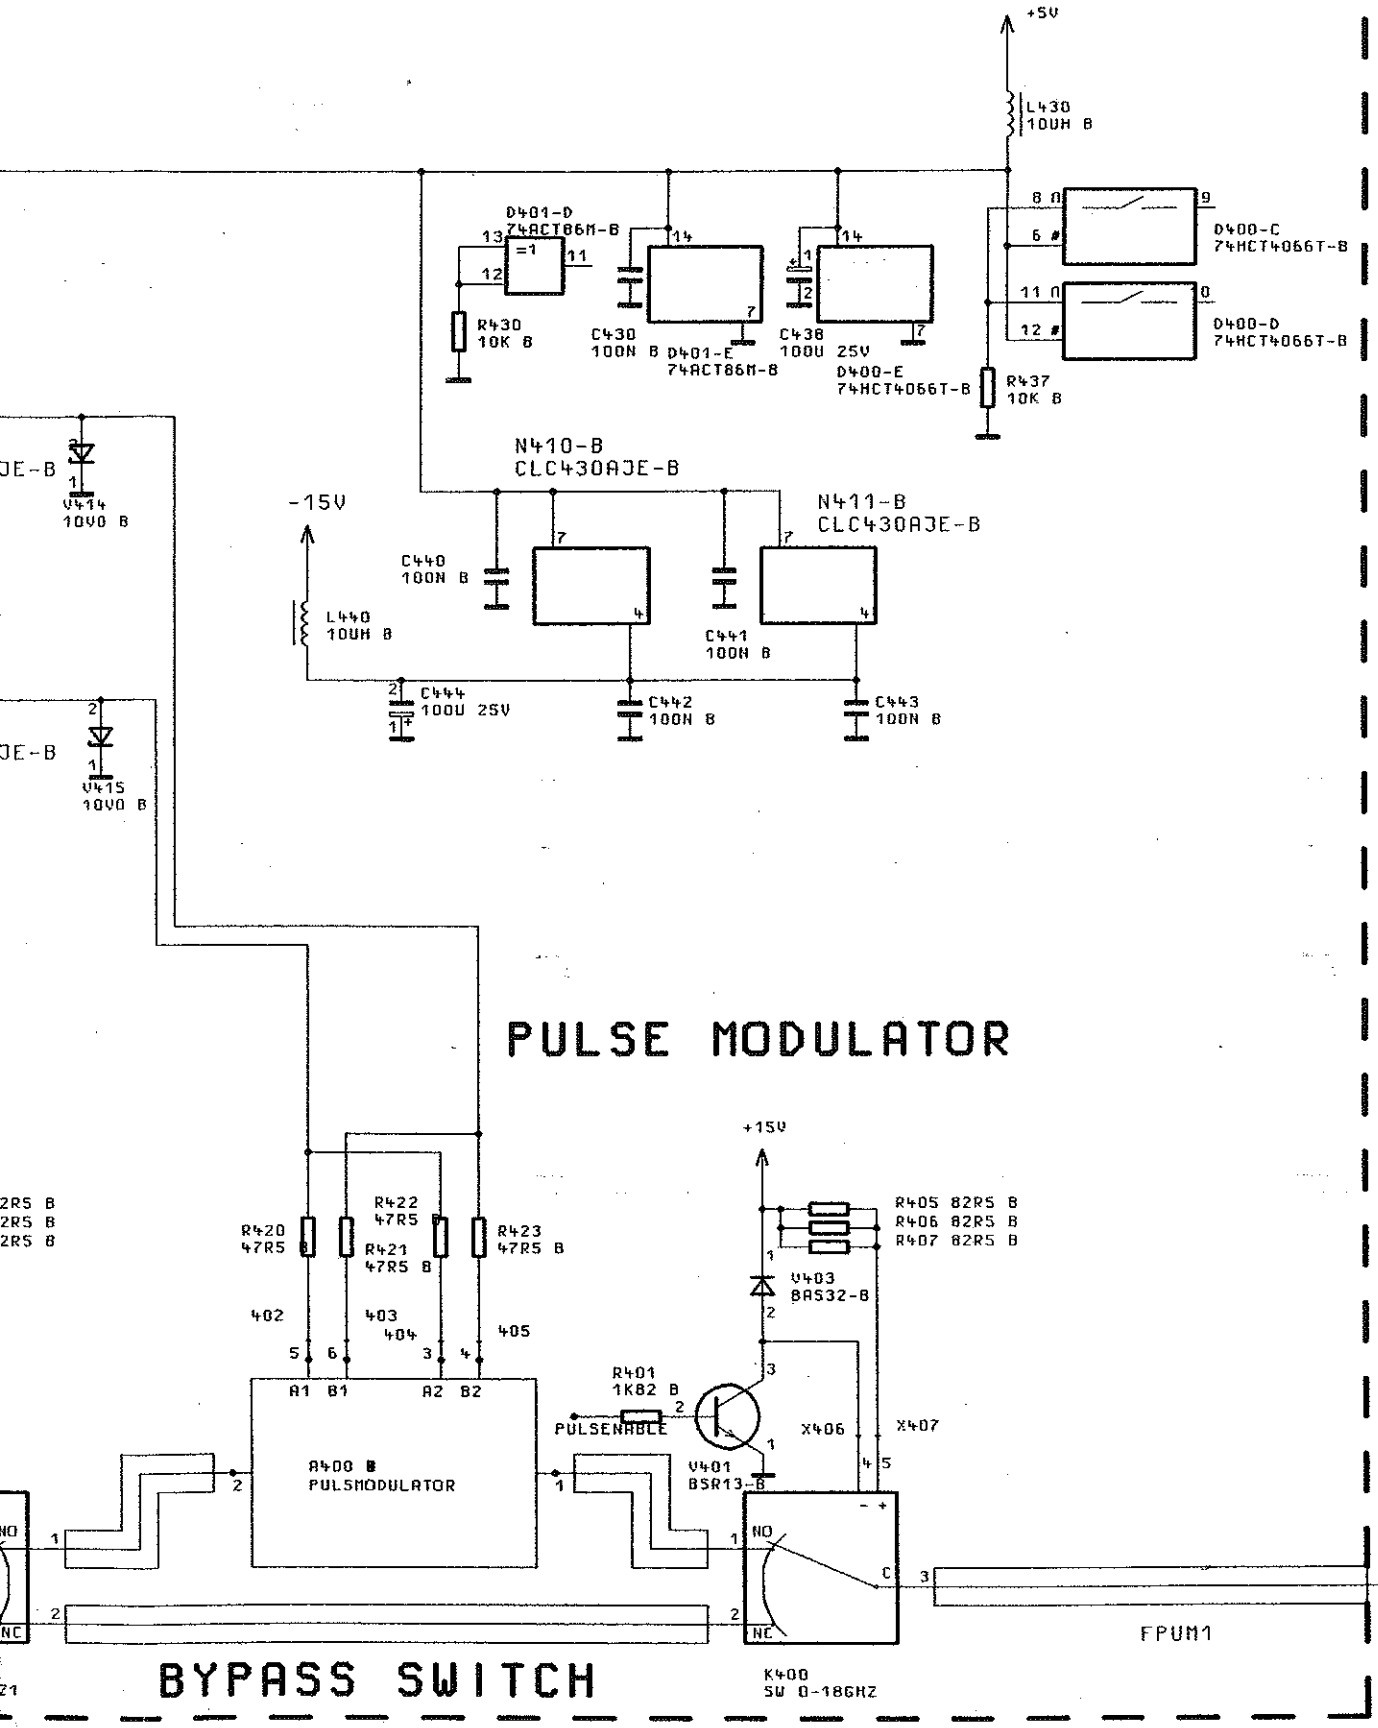

02/	48738	01.03.93	JN	1GPK	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		JN	PULSMODULATOR
				GEPR.			PULSE-MODULATOR
				NORM			
				PLOTT	04.08.94		
/	48738	12.92	JN	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1036.6370.01S
REND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SM-B3			REG.I.V. 1036.6340 ERSTE Z.

BLATT-NR. 4 v. BL.

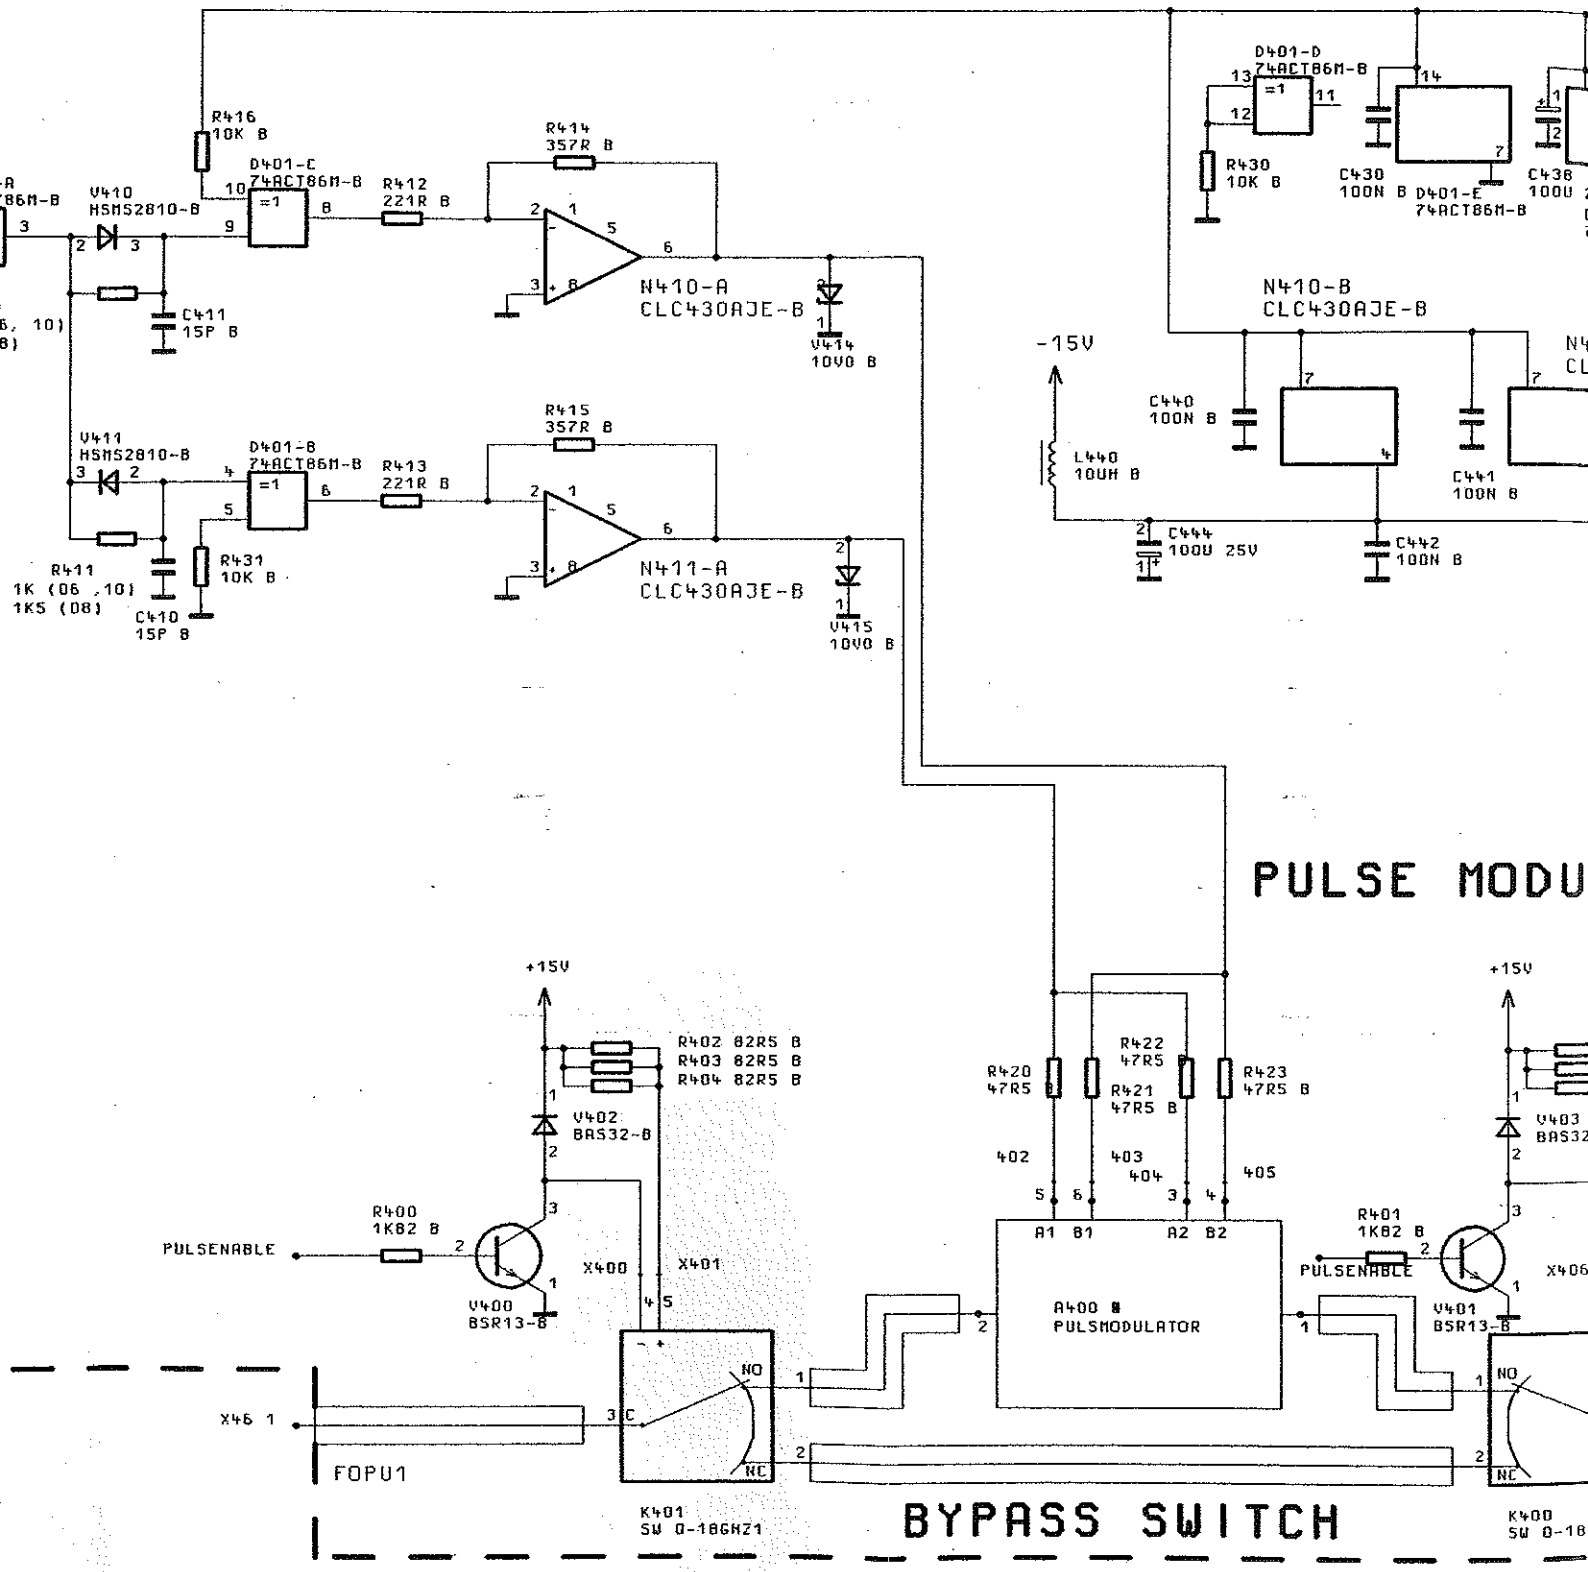

02/	48738	01.03.93	JN	1GPK	TAG	NAME
				BEARB.		JN
				GEPR.		
				NORM		
				PLOTT	04.08.94	
/	48738	12.92	JN	ROHDE&SCHWARZ		
REND. IND.	RENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET	SM-B3	


OMLAUF GILT FUER VAR.06, 08, 10


UIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.06, 08, 10

FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

B

MODE SELECT

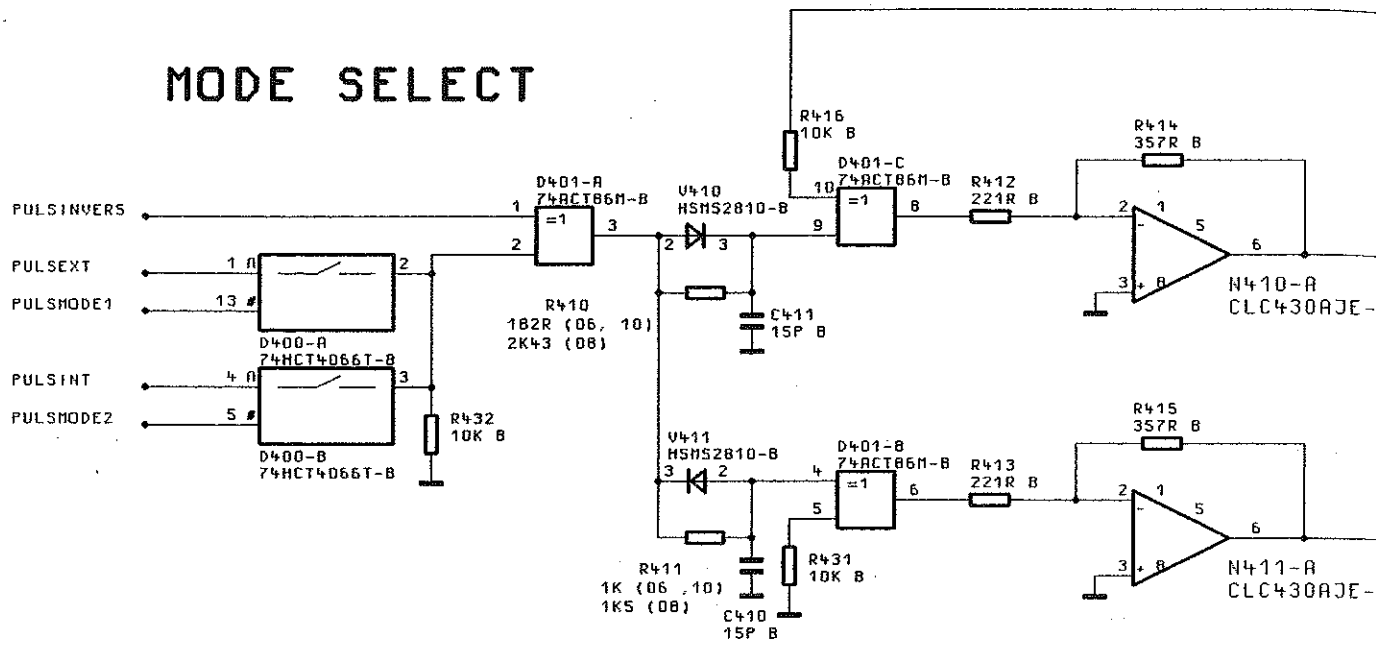


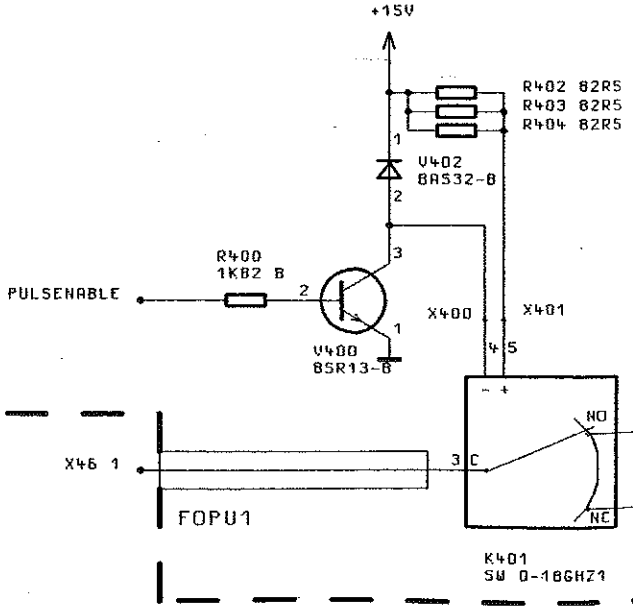


STROMLAUF GILT FUER VAR.06, 08, 10

CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.06, 08, 10

ZEICHN.-NR.

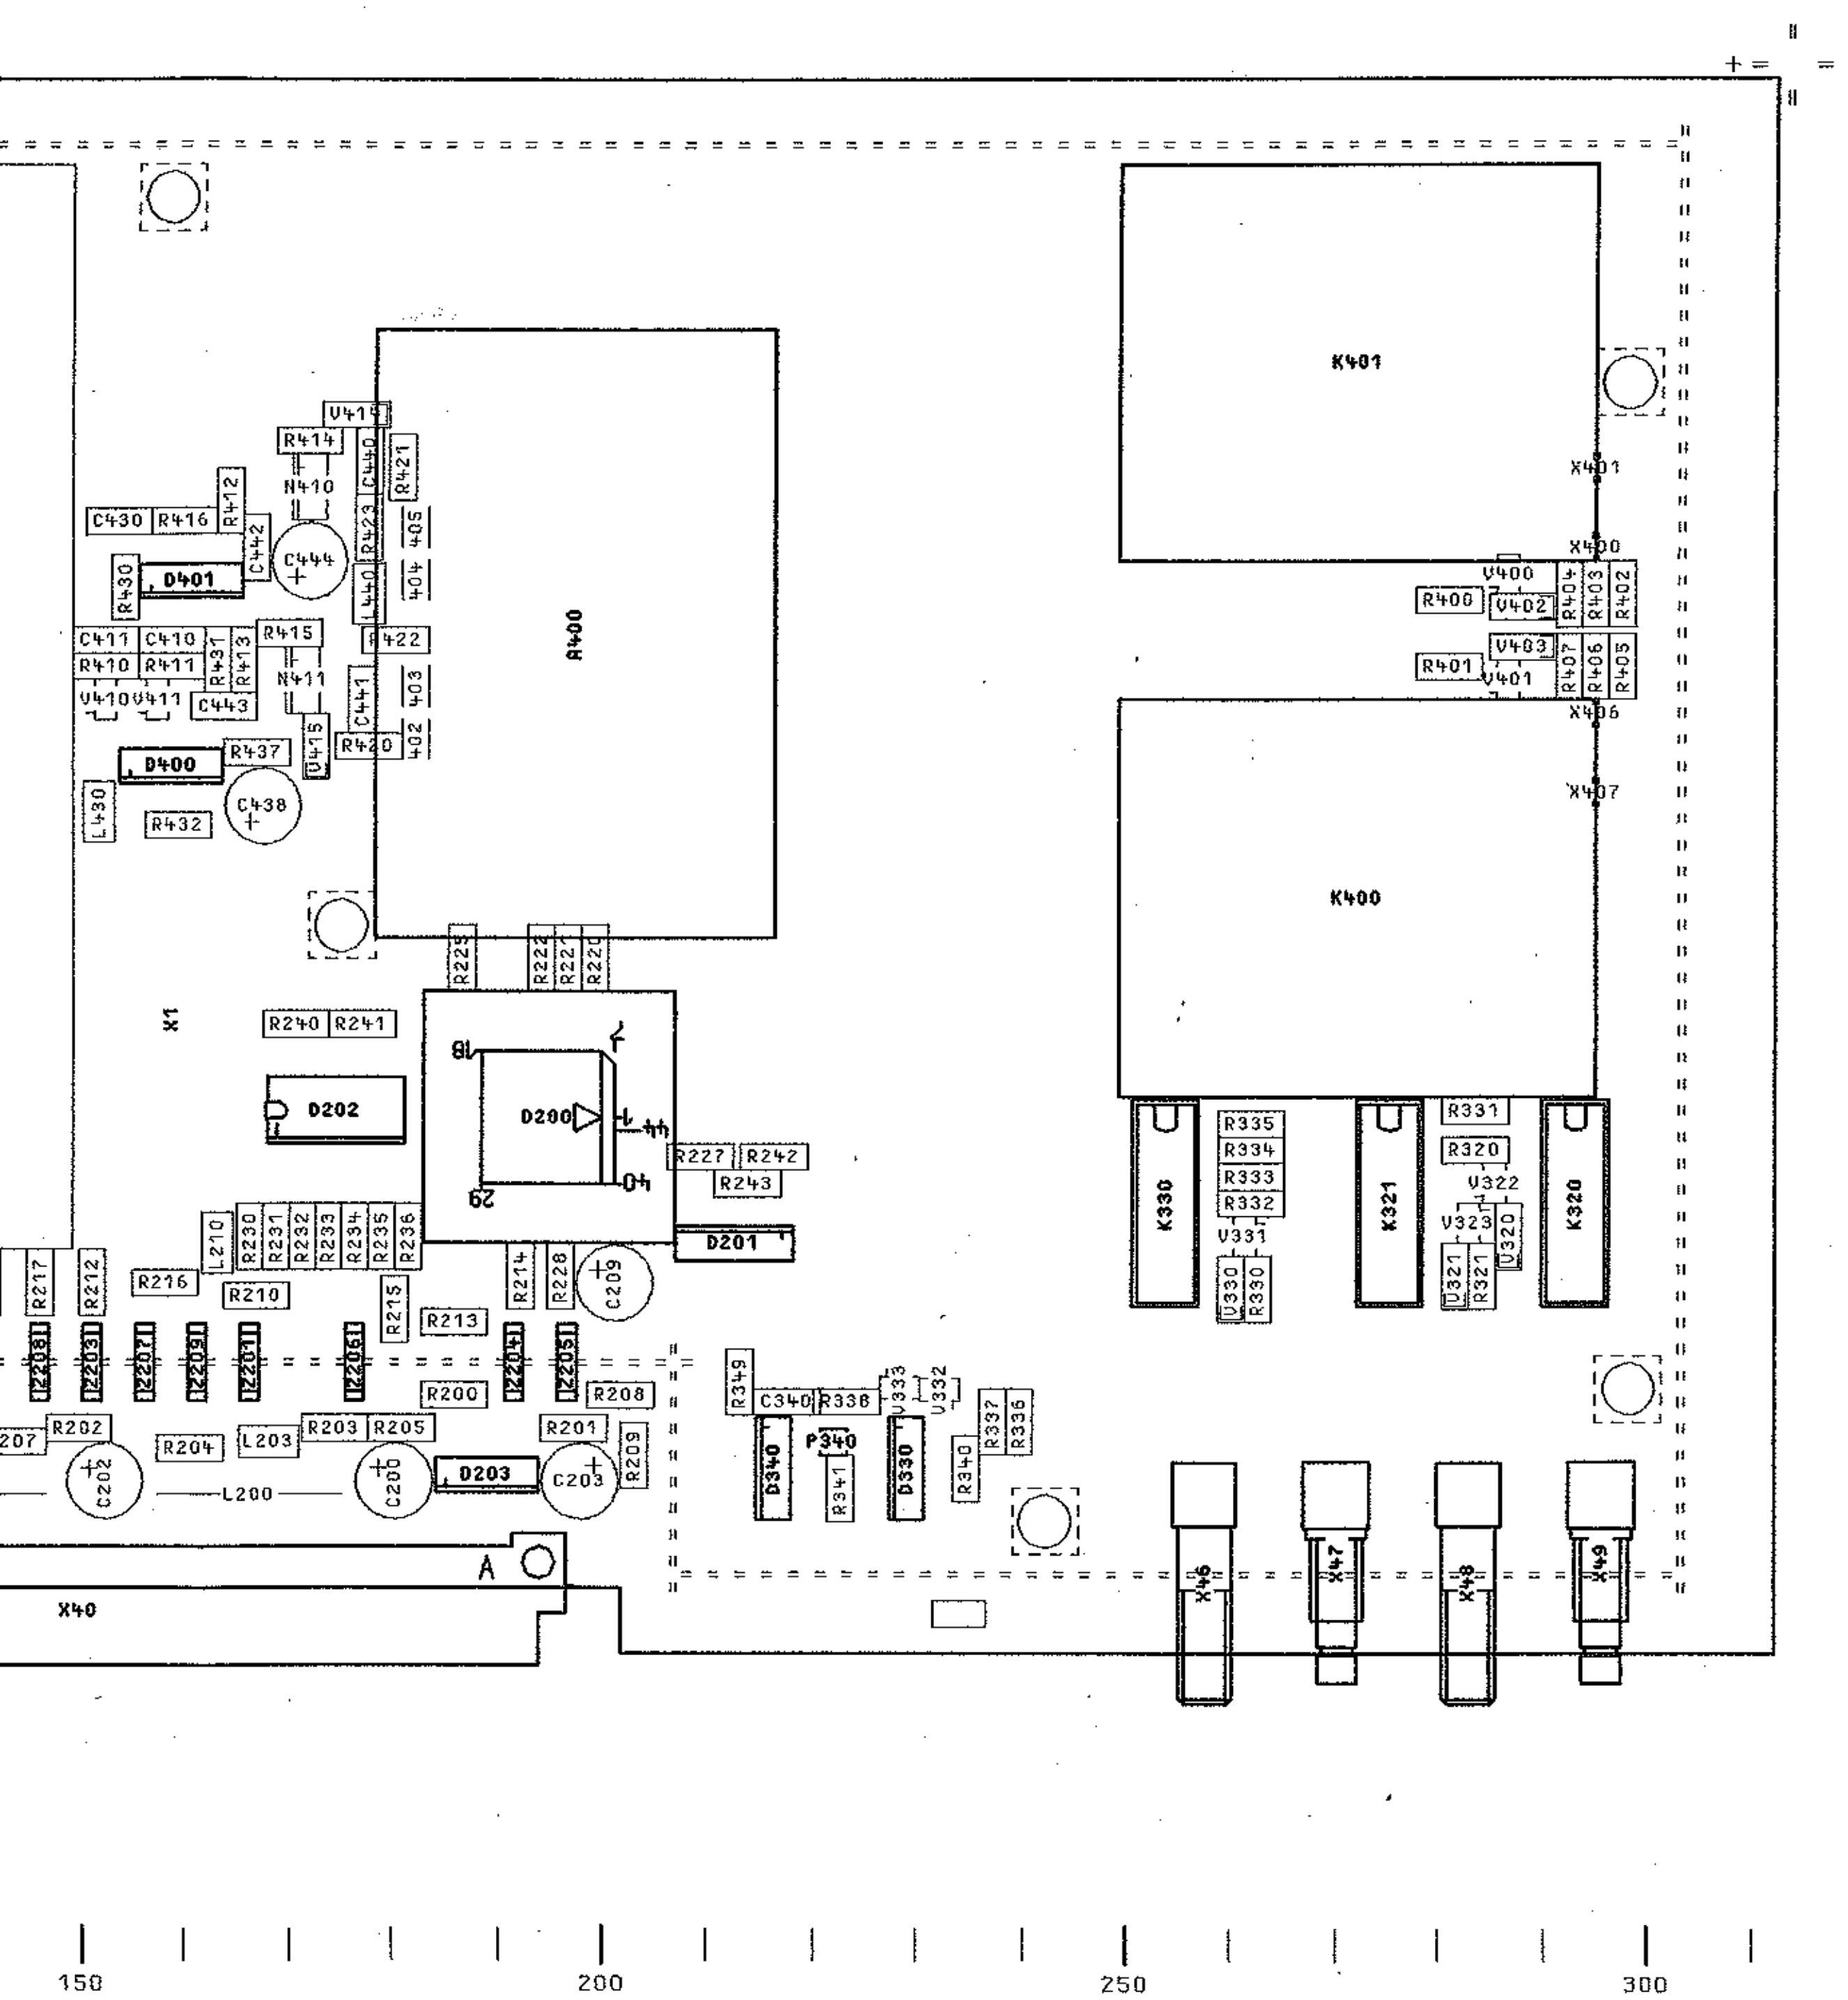

01/00				1GPK	TAG	NAME	BENENNUNG	
				BEARB.		JN	PULSMODULATOR	Z
				GEPR.		JN	PULSE-MODULATOR	
				NORM				
				PLOTT	28.07.93			
				ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1036.6370.01	BLATT-NR. 1+
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET	SM-B4		VEG.I.V. 1036.6340	ERSTE Z.

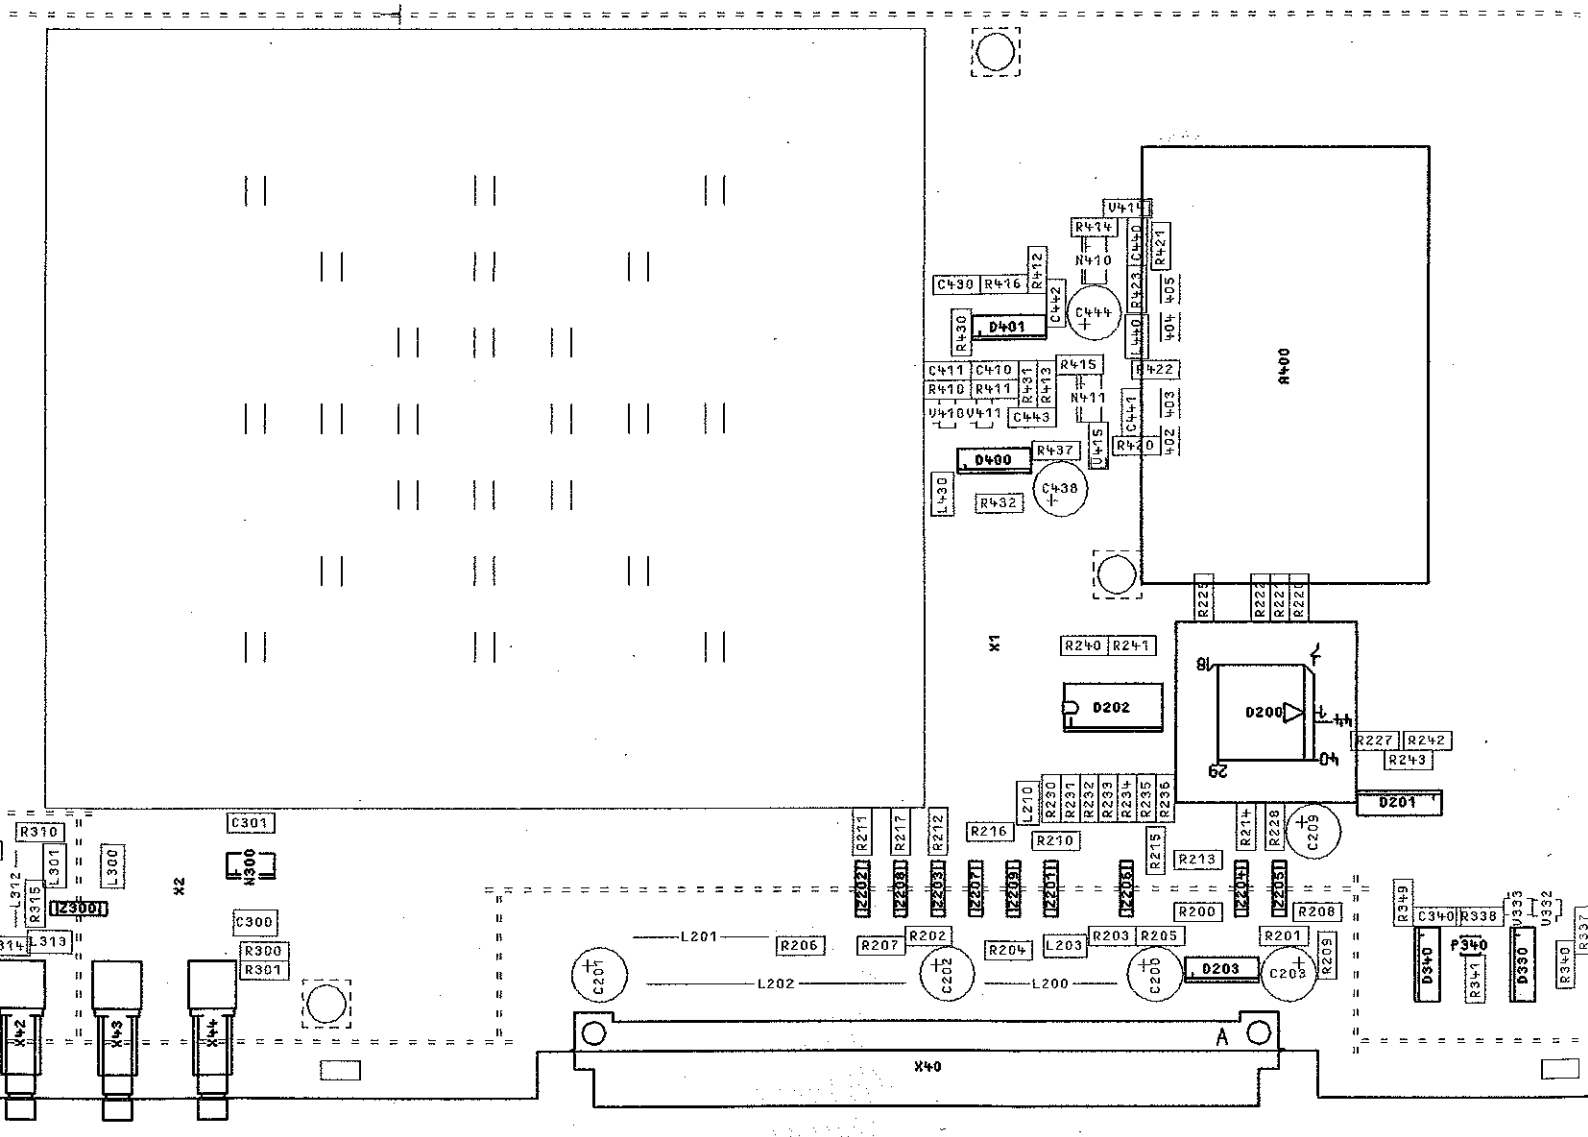

50 100 150 200


BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN, TRIMMWERTE, BRUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BRUTEILE SIEHE SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

TUNG: EGB!
STATISCH GEFAEHRDETE
IENTE ERFORDERN EINE
ONDERE HANDHABUNG.
NTION ESD!
ATIC SENSITIVE DEVICES
E A SPECIAL HANDLING

81/00

REND. IND. | AENDERUNGS-MITTEILUNG

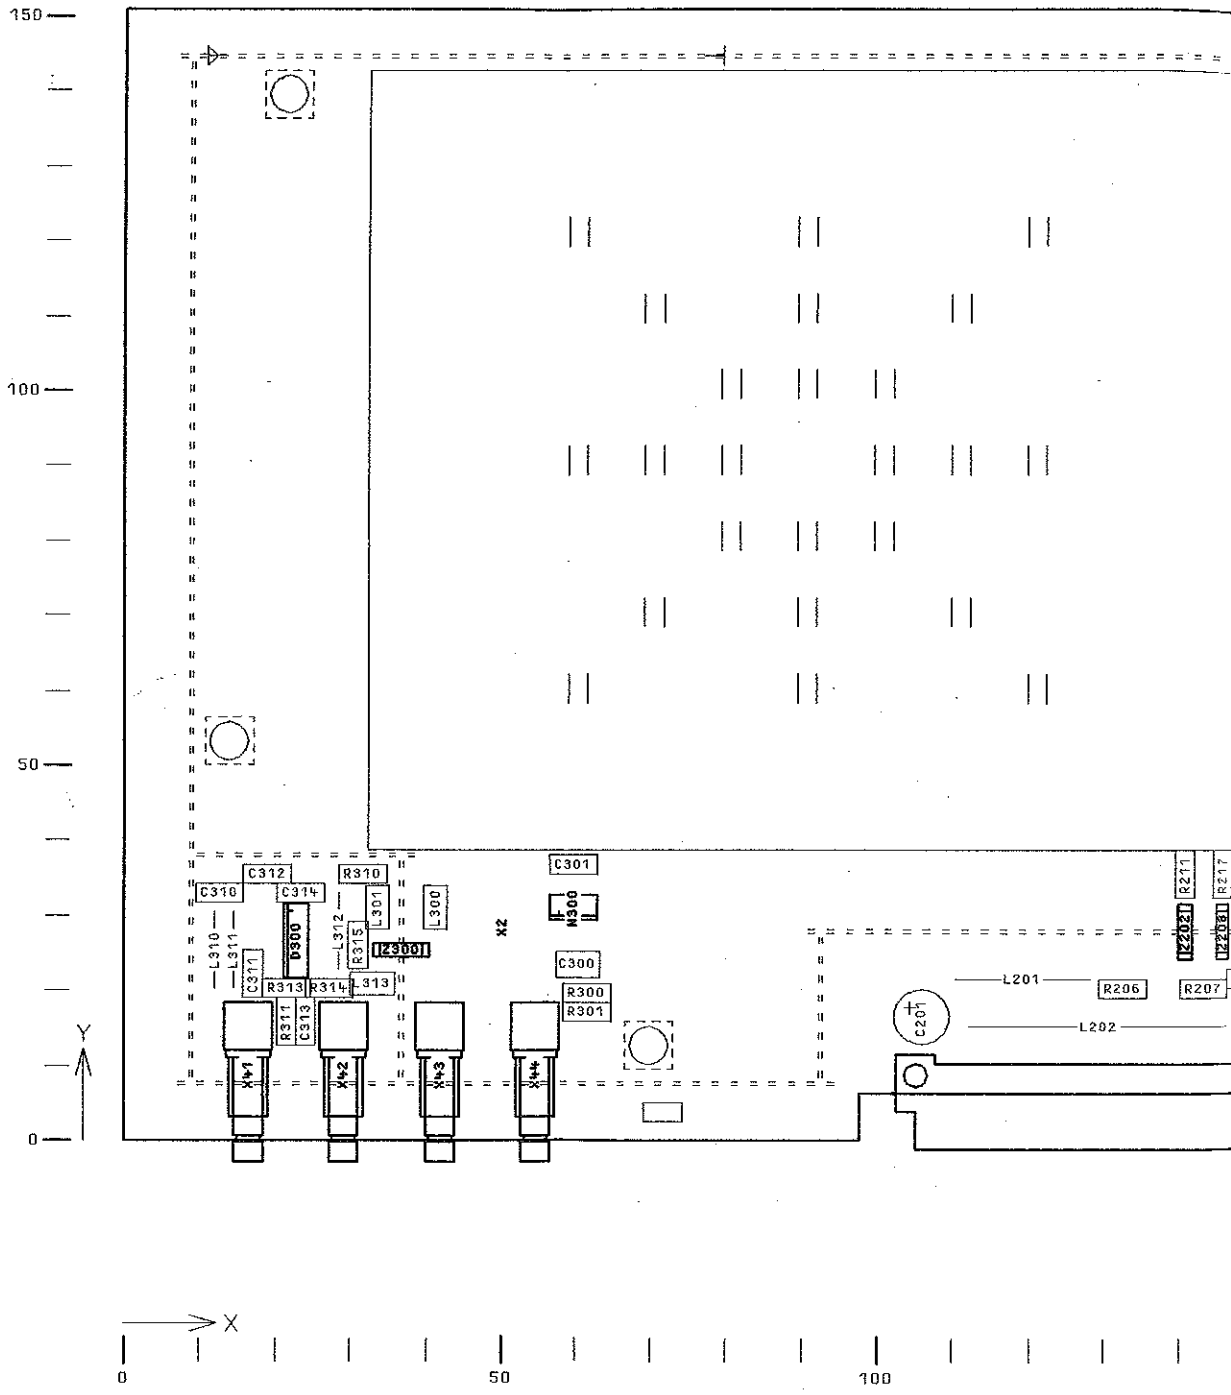

DIESE ZEICHNUNG IST EIN RECHNERAUSDRUCK, RENDERUNGEN KOENNEN NUR DURCH RENDERN DES DATENSATZES ERFOLGEN
FUER DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR.

DARSTELLUNG SEITE B

VIEW ON SIDE B

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.

ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN, TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.